

**Procedura aperta telematica di rilievo comunitario per la fornitura, installazione e posa in opera di lampade scialitiche e sistemi pensili – divisa in due lotti distinti e separati – per le necessità del Nuovo Ospedale “San Cataldo” – N. GARA 8729823 – Lotto n.1 CIG 9412628A57 / LOTTO n.2 CIG 9412653EF7.**

**Verbale n.1 del 18/11/2022 (seduta pubblica in modalità videoconferenza), giusta convocazione del 16/11/2022**

In data 18/11/2022 alle ore 10 presso l'Area Gestione del Patrimonio, sita in Viale Virgilio n. 31, si procede agli adempimenti previsti come prima fase dal Disciplinare di gara relativo all'affidamento della fornitura in oggetto.

Presiede i lavori il RUP, Direttore Area Gestione del Patrimonio dott. Lorenzo Francesco RUSSO, assistito dalla Dott.ssa Claudia Caricasole in qualità di teste e segretaria verbalizzante, ed alla presenza della dott.ssa Adele D'onofrio, in qualità di teste, per la verifica della documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti nella procedura de qua.

Si dà atto che sono presenti i seguenti rappresentanti, muniti di delega:

- sig. Maurizio TRIOLO, delegato dall'A.U. della ditta Item Oxygen srl, prodotto documento di identità N.749274;

Premesso che:

- con Deliberazione DG n. 2008 del 21/10/2022 è stata autorizzata l'indizione della procedura aperta telematica di rilievo comunitario nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32 e 60 del d. lgs. n. 50/2016, con l'aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, per la fornitura di sistemi pensili e lampade scialitiche per le necessità del Nuovo Ospedale “San Cataldo” di Taranto;
- è stata disposta la pubblicazione del bando di gara, in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 2022/S -189-532203 del 27/09/2022, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.114 del 30/09/2022, su due quotidiani a diffusione nazionale, stabilendo, alle ore 12 del giorno 2/11/2022 la data di scadenza per la presentazione delle offerte ed alle ore del 10 del giorno 4/11/2022 quella per l'apertura telematica delle offerte pervenute, entrambe successivamente prorogate rispettivamente al 16/11/2022 ore 12 e al 18/11/2022 ore 10.
- già con comunicazione Empulia PI283081-22 si trasmetteva apposito link – come di seguito riportato : <https://asitaranto1.webex.com/asitaranto1/j.php?MTID=m28cc986ab90eb4d8caa2d6340164b029> – idoneo a consentire il collegamento in modalità "videoconferenza" relativo alla apertura delle buste amministrative rese in sede di offerta, previsto per il giorno 18.11.2022 ore 10 presso gli uffici dell'Area Gestione del Patrimonio - Viale Virgilio n.ro 31 – Taranto;







































Si procede, pertanto, alla visualizzazione a sistema delle offerte pervenute entro i termini fissati nel disciplinare di gara, con il seguente ordine di arrivo:

Protocollo	Data di invio	Operatore economico
PI278278-22	14/11/2022 12:58	ALTAMED srl
PI280020-22	14/11/2022 17:08	ITEM OXYGEN SRL (Ritirata)
PI280305-22	15/11/2022 11:17	ITEM OXYGEN SRL (Ritirata)
PI280674-22	15/11/2022 16:08	ITEM OXYGEN SRL
PI280703-22	15/11/2022 16:43	GETINGE ITALIA SRL
PI280711-22	15/11/2022 16:51	STERIS SRL
PI281136-22	15/11/2022 17:57	HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING SRL
PI282244-22	16/11/2022 8:46	OPT SURGISYSTEMS
PI282426-22	16/11/2022 9:41	MEDICAL LAB SYSTEM SRL
PI282735-22	16/11/2022 11:54	CARDIO VASCULAR SRL

Successivamente si prosegue alla verifica formale delle “buste amministrative” delle offerte presentate dagli operatori economici interessati alla partecipazione procedendo con l'apertura delle buste contenenti la documentazione richiesta nel disciplinare di gara – che di seguito si riporta – ed al controllo della completezza dei documenti allegati e della relativa sottoscrizione con firma digitale:


1. Documento di Gara Unico Europeo
2. Procura speciale (eventuale)
3. Garanzia provvisoria
4. Dichiarazione, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice
5. Ricevuta di versamento della contribuzione dovuta nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
6. Dichiarazioni varie - relativa l'Avvalimento (eventuale)
7. Dichiarazione di avvenuto sopralluogo
8. Ulteriore documentazione amministrativa

Tutto ciò premesso, si procede all'apertura a "sistema" della busta contenente la documentazione della ditta "RTI Altamed S.r.l. - ITEM OXYGEN SRL" che partecipa al Lotto n.2. La documentazione allegata risulta essere la seguente:

  <a href="#">Allegato_1 DGUE_ALTAMED.pdf.p7m</a>
  <a href="#">0019_004833449026383_PROVV_623290090_9_LOTTO 2.pdf.p7m</a>
  <a href="#">RicevutaANAC_LOTTO 2.pdf.p7m</a>
  <a href="#">Attestato di sopralluogo_ALTAMED.pdf.p7m</a>
  <a href="#">Attestato sopralluogo.pdf.p7m</a>
  <a href="#">Allegato_1 DGUE Lotto 2 ITEM.pdf.p7m</a>
  <a href="#">C.I. ANNA FIORINO.pdf.p7m</a>
  <a href="#">Dich. certificati.pdf.p7m</a>
  <a href="#">ISO14001 2015 -ITEM OXYGEN SRL - EMS Certificate.pdf.p7m</a>
  <a href="#">UNI EN ISO 9001.pdf.p7m</a>
  <a href="#">Dich art 80 D Lgs 50_15 corr e smj_Cravera.pdf.p7m</a>
  <a href="#">Altamed S.r.l. dichiaraz variazione ragione sociale.pdf.p7m</a>
  <a href="#">dich di COPIA CONFORME agli originali.pdf.p7m</a>
  <a href="#">Dichiarazione permanenza requisiti.pdf.p7m</a>
  <a href="#">dich elenco referenze L2_STATIVI PENSILI.pdf.p7m</a>
  <a href="#">MOD. DICH. SOST. ISCRIZ. CCIAA_ALTAMED.pdf.p7m</a>
  <a href="#">Verbale Assemblea Notaio Doria Rep. 437706 del 29.1.2021.pdf.p7m</a>
  <a href="#">Certificato ISO 9001_2015_ALTAME_SCAD 2024.pdf.p7m</a>
  <a href="#">dichiarazione di partecipazione in costituendo RTI.pdf.p7m</a>

La documentazione presentata risulta essere conforme a quanto previsto nel disciplinare di gara.

Si procede all'apertura della busta contenente la documentazione della ditta "ITEM OXYGEN SRL" che partecipa al Lotto n.1. La documentazione allegata risulta essere la seguente:

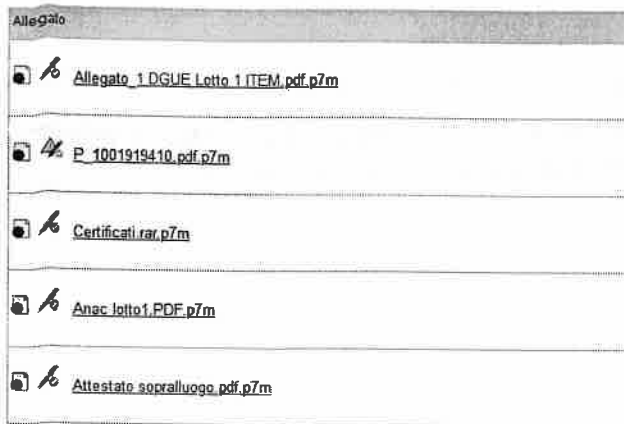


Il Presidente del seggio di gara rileva quanto segue:

- la polizza fideiussoria provvisoria presentata è prestata per un periodo inferiore, ovvero di 180 giorni in luogo dei 360 richiesti dalla Legge di Gara;

La restante documentazione risulta essere conforme a quanto previsto nel Disciplinare di gara.

Si procede all'apertura a "sistema" della busta contenente la documentazione della ditta "GETINGE ITALIA srl" che partecipa ai Lotti nn. 1 e 2. La documentazione allegata risulta essere la seguente:

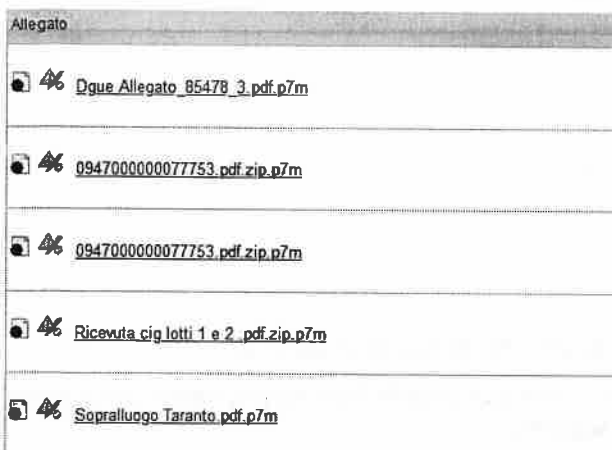


Il Presidente del seggio di gara rileva che:

- l'operatore economico ha prodotto, nell'ambito del DGUE, la dichiarazione di cui all'art.80 comma 5 lett. c), riferita l'inadempimento contrattuale e incameramento della cauzione disposto da ASST Franciacorta. E' necessario acquisire documentazione integrativa in relazione agli eventi sottesi al predetto inadempimento;

La restante documentazione risulta essere conforme a quanto previsto nel disciplinare di gara.

Si procede all'apertura a "sistema" della busta contenente la documentazione della "STERIS srl" che partecipa al lotto n.1. La documentazione allegata risulta essere la seguente:

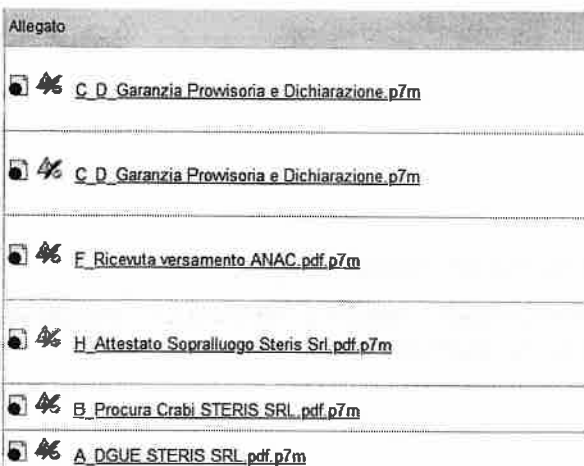

Il Presidente del seggio di gara rileva che occorre specificare, nell'ambito del prodotto DGUE, le voci relative l'art.80 lett. C) , c-bis) c-ter);















La restante documentazione risulta essere conforme a quanto previsto nel Disciplinare di gara.

Si procede all'apertura a "sistema" della busta contenente la documentazione della "HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING SRL" che partecipa al Lotto n.1. La documentazione allegata risulta essere la seguente:

Allegato	
	 <a href="#">A_Allegato_1.DGUE_HSC_MANDATARIA.pdf.p7m</a>
	 <a href="#">C_CAUZIONE PROVVISORIA.pdf.p7m</a>
	 <a href="#">C_CAUZIONE PROVVISORIA.pdf.p7m</a>
	 <a href="#">F_Ricevuta_ANAC.PDF.p7m</a>
	 <a href="#">H_Dichiarazione di awenuto sopralluogo.pdf.p7m</a>
	 <a href="#">A_Allegato_1 DGUE_PUGLIA MEDICAL_MANDANTE.pdf.p7m</a>
	 <a href="#">A_Dichiarazione capacita eco_fin_HSC MANDATARIA.pdf.p7m</a>
	 <a href="#">A_Dichiarazione capacita eco_fin_Puglia Medical MANDANTE.pdf.p7m</a>
	 <a href="#">C_DICHIARAZIONE ISO_HSC.pdf.p7m</a>
	 <a href="#">C_ISO9001 2015 - HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING SRL- MANDATARIA.pdf.p7m</a>
	 <a href="#">C_ISO9001 2015 PUGLIA MEDICAL_MANDANTE.pdf.p7m</a>
	 <a href="#">I_Impegno a costituire RTI.pdf.p7m</a>
	 <a href="#">L_Dichiarazione copia conforme.pdf.p7m</a>

La documentazione presentata risulta essere conforme a quanto previsto nel disciplinare di gara.

Si procede all'apertura a "sistema" della busta contenente la documentazione della "OPT SurgiSystems" che partecipa ai lotti n. 1 e n.2. La documentazione allegata risulta essere la seguente:

Allegato	
	 <a href="#">A_Allegato_1 DGUE.pdf.p7m</a>
	 <a href="#">Polizza unita def. opt - asl taranto 6635707.pdf.p7m.p7m</a>
	 <a href="#">Polizza unita def. opt - asl taranto 6635707.pdf.p7m.p7m</a>
	 <a href="#">E_Pagamento ANAC.pdf.p7m</a>
	 <a href="#">H_Dichiarazione di sopralluogo.pdf.p7m</a>
	 <a href="#">G_Allegato_1 DGUE LM.pdf.p7m.p7m</a>
	 <a href="#">I_Certificazione ISO.pdf.p7m</a>

La documentazione presentata risulta essere conforme a quanto previsto nel disciplinare di gara.

Si procede all'apertura a "sistema", della busta contenente la documentazione della ditta "MEDICAL LAB SYSTEM srl" che partecipa al Lotto n.1. La documentazione allegata risulta essere la seguente:

Allegato

Allegato\_1 DGUE.pdf.p7m

P\_1001923483.pdf.p7m.p7m

P\_1001923483.pdf.p7m.p7m

Ricevuta\_301010011249294925 PDF.p7m

SOPRALLUOGO.pdf.p7m

La documentazione presentata risulta essere conforme a quanto previsto nel disciplinare di gara.

Si procede all'apertura a "sistema" della busta contenente la documentazione della "CARDIO VASCULAR SRL" partecipa ai Lotti n.1 e n.2. La documentazione allegata risulta essere la seguente:

Allegato

Allegato\_1 DGUE.pdf.p7m

Polizza Provisoria COMPRESSO CARDIO VASCULAR STAZIONE APPALTANTE.pdf.p7m.p7m

Polizza Provisoria COMPRESSO CARDIO VASCULAR STAZIONE APPALTANTE.pdf.p7m.p7m

versamenti\_anac.pdf.p7m

Dichiarazione avvenute sopralluogo.pdf.p7m

CARD0950Q1796\_certificate\_release 20200919.pdf.p7m

La documentazione presentata risulta essere conforme a quanto previsto nel disciplinare di gara.

Il RUP decide di attivare il procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d. lgs. n. 50/2016 in merito ad ognuna delle suesposte criticità richiedendo le dovute integrazioni attraverso la piattaforma EmPulia.

Tutto ciò premesso, preso atto che non risultano rilasciate dichiarazioni a verbale da parte dei soggetti presenti, sarà comunicata successivamente prossima seduta pubblica all'esito del provvedimento di ammissione/esclusione degli operatori economici partecipanti.

Si allega al presente Verbale e ne costituisce parte integrante e sostanziale, conversazione intercorsa durante lo svolgimento della seduta pubblica.

Il Presidente dichiara la seduta conclusa.

La seduta è chiusa alle 14.10

dott. Lorenzo Francesco RUSSO, presidente di seggio .....

dott.ssa Claudia CARICASOLE, teste e segretario verbalizzante .....

dott.ssa Adele D'ONOFRIO, teste .....



